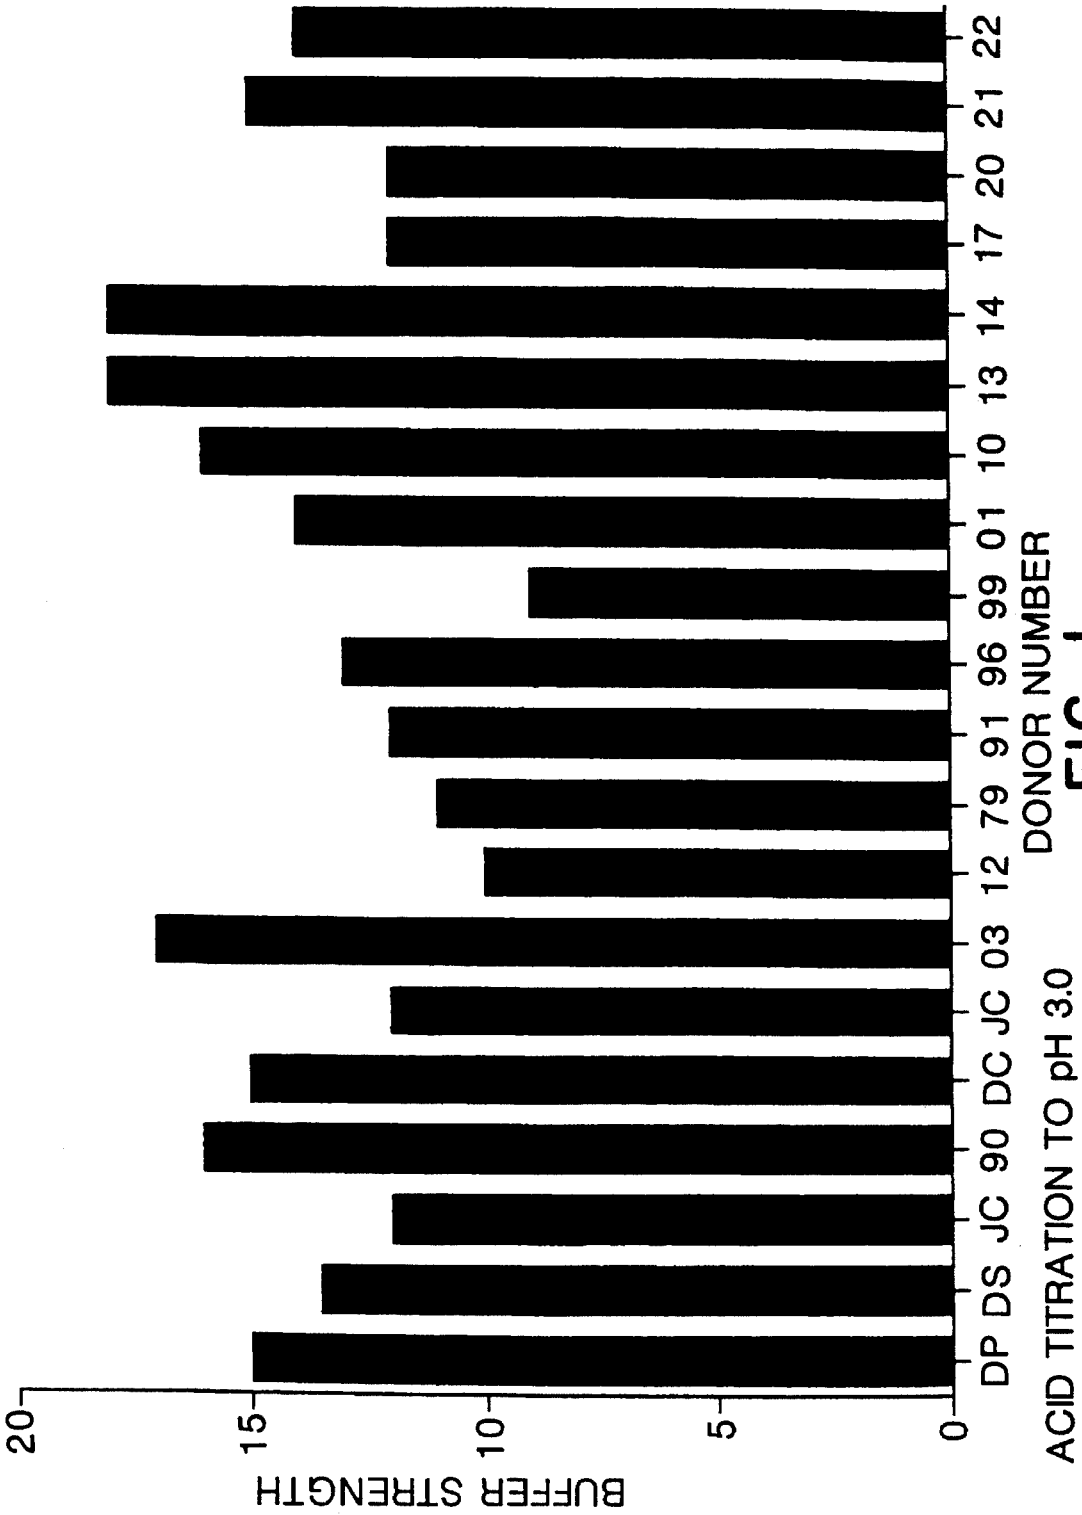
BUFFER STRENGTH
20
15
10
5
0
DP DS JC 90 DC JC 03 12 79 91 96 99 01 10 13 14 17 20 21 22
DONOR NUMBER
ACID TITRATION TO pH 3.0

FIG. 1