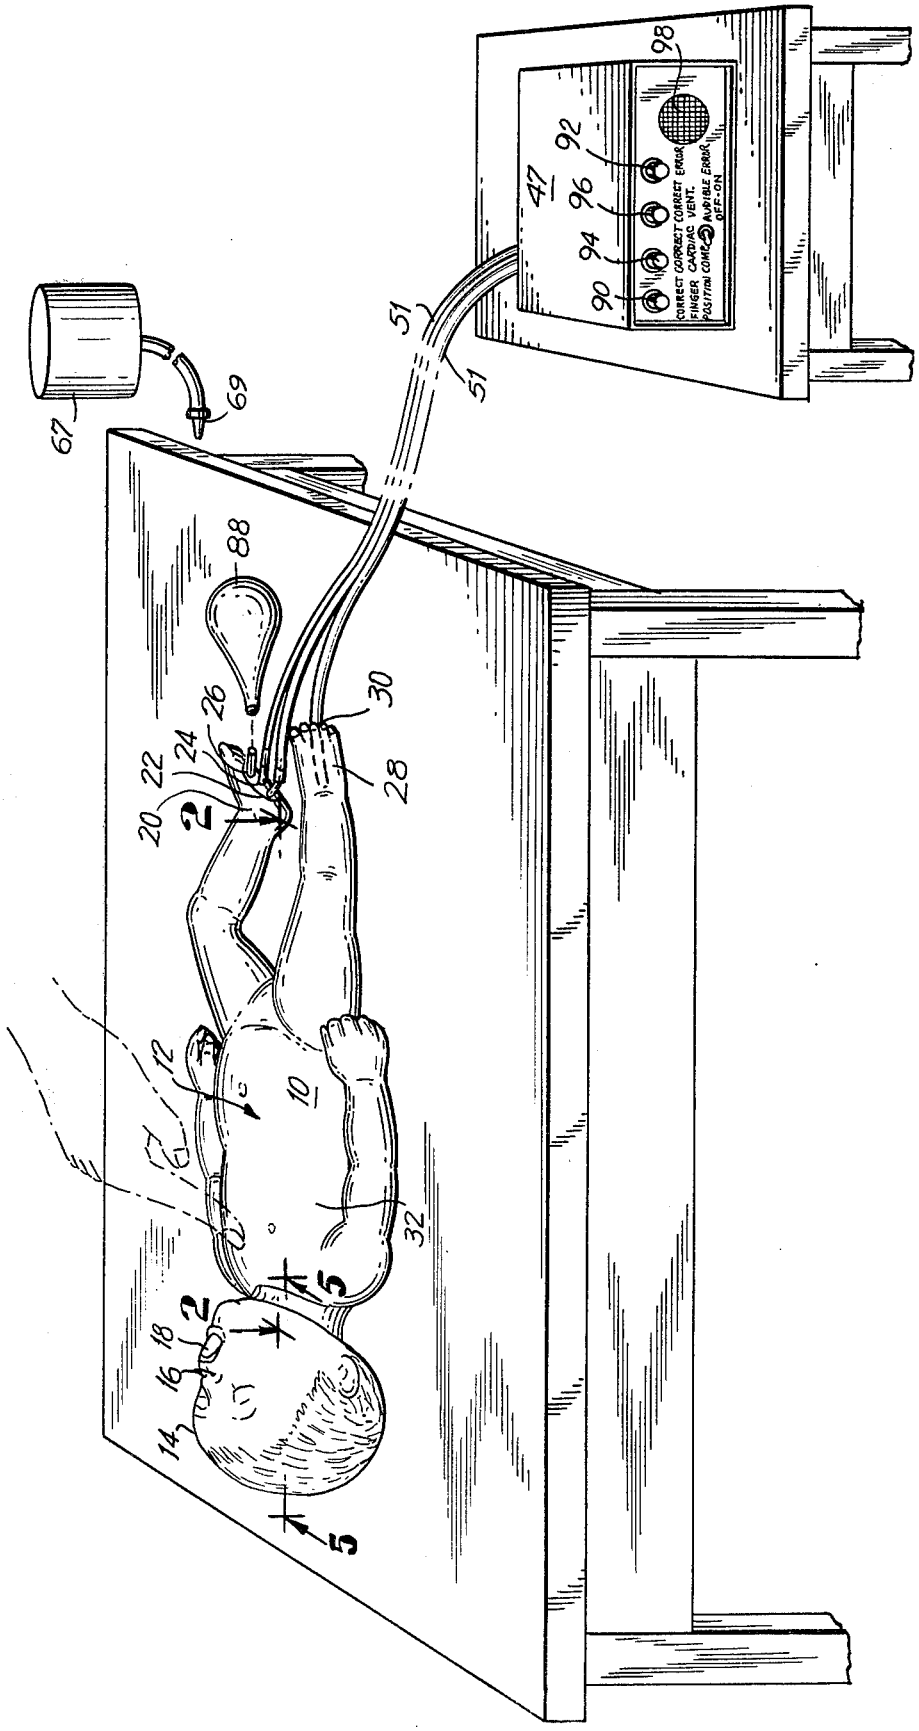
CORRECT
CORRECT
CORRECT
ERROR
FINGER
CARDIAC
VENT.
POSITION
CORRECT
AUDIBLE
ERROR
OFF-ON
98
92
47
96
94
90
51
51
67
69
88
30
26
24
22
20
2
28
12
10
32
5
2
18
16
14
5

FIG. 1